




杭州爱华仪器有限公司

HANGZHOU AIHUA INSTRUMENTS CO.,LTD.



AWA6228A

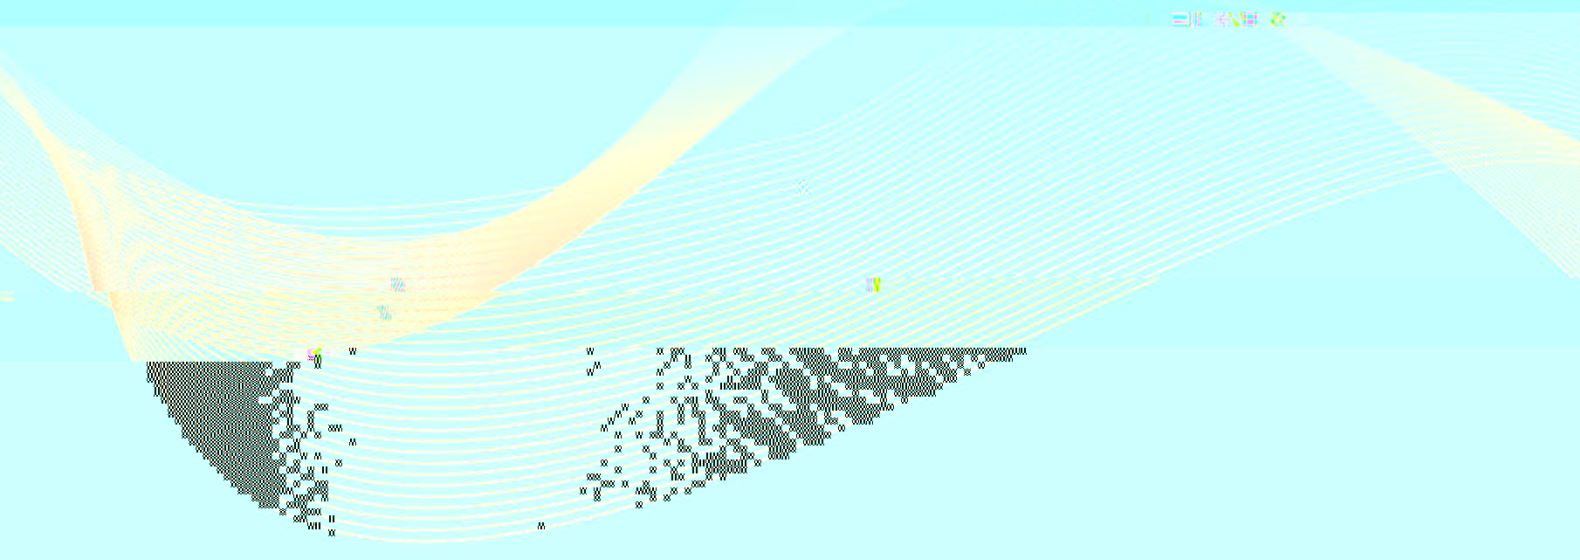



中华人民共和国

计量器具型式批准证书

杭州爱华仪器有限公司

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国

计量法实施细则的有关规定，对你单位提出的申请

式样

进行型式批准



2025S295-33

经批准的计量器具新产品（名称、型号等）：

计量器具名称	型号	规格	准确度等级
动分析仪 (声级计)	AWA6228A	A 计权声级 17 dB~144 dB C 计权声级 20 dB~144 dB Z 计权声级 35 dB~144 dB 频率范围：10 Hz~20 kHz 类型：X 类	1 级

测量范围：

发证日期 2025年5月14日

发证机关(盖章)



意事

概

主

主 性 指标
基本性 指标





:
:

其它性

功



:

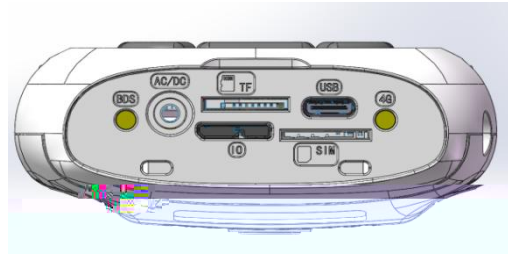

按



:
:
号、 写定义



使 方

前期准备

使 前准备

使

外接

检查及更换

开机和复位

噪声

主



总值 分
总值 分



总值 录



25-12-04 12:05:15

总值积分 醒目

LAFp	=	59.3dB
LCFp	=	65.7dB
LZFp	=	66.3dB

Ts: 00:00:10 A/F > ⚙

记录 准备中 取消

总值 录列





25-12-04 13:38:55

总值积分 醒目

LAp

LAFp	=	50.8dB
LASp	=	51.8dB
LAIp	=	64.9dB
LCFp	=	55.4dB
LZFp	=	58.9dB

Ts: 00:00:10 A/I > ⚙

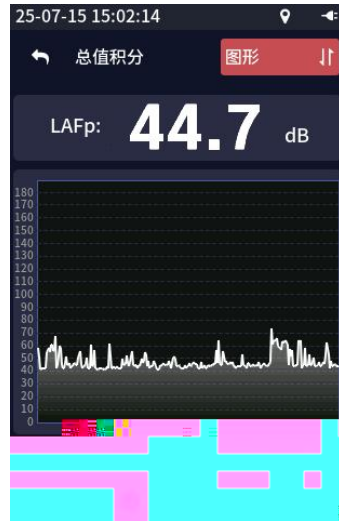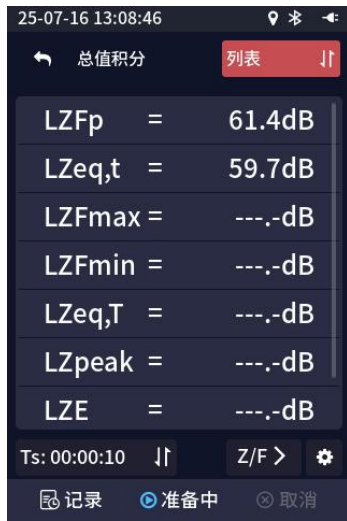

总值 录图形



启动 分



指




总值 分



:

启动模式:	超限 >
指标:	LAFp >
限值:	70dB >

分布图

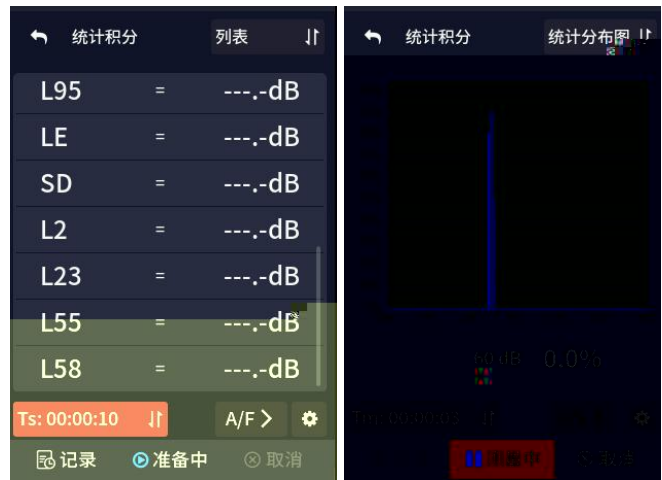


分布图





分

加指标

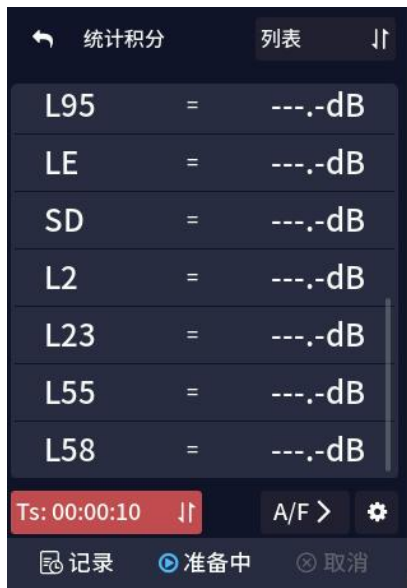


列



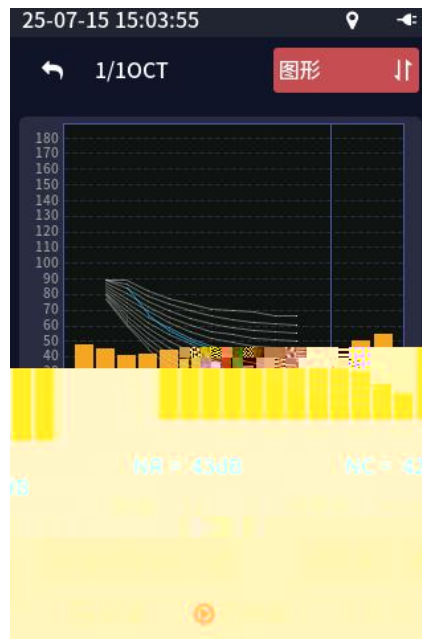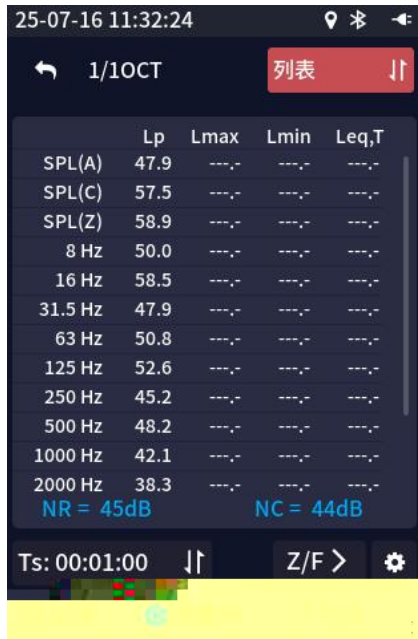

图形



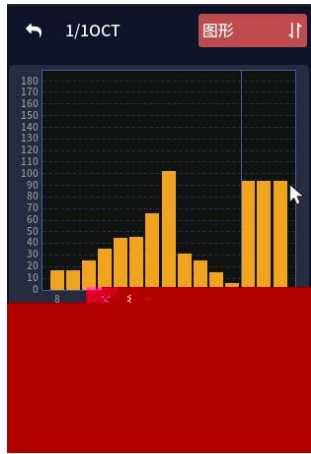

列

25-07-16 11:22:54

1/3OCT 列表

	Lp	Lmax	Lmin	Leq,T
SPL(A)	60.8	---	---	---
SPL(C)	61.4	---	---	---
SPL(Z)	63.6	---	---	---
5 Hz	-43.4	---	---	---
6.3 Hz	-34.5	---	---	---
8 Hz	-23.3	---	---	---
10 Hz	-21.0	---	---	---
12.5 Hz	-18.1	---	---	---
16 Hz	-10.8	---	---	---
20 Hz	-2.7	---	---	---
25 Hz	1.2	---	---	---
31.5 Hz	7.5	---	---	---
40 Hz	10.0	---	---	---

Ts: 01:00:00 A/F > ⚙

记录 准备中 取消

:

图形





定义 权



:



启动模式: 按键 >

延迟: 0s >

数字记录仪:

自定义计权:

中心频率	U/dB	T/dB
5 Hz	0.0	-∞
6.3 Hz	0.0	-∞
8 Hz	0.0	-∞
10 Hz	0.0	-∞
12.5 Hz	0.0	-∞
16 Hz	0.0	-56.7
20 Hz	0.0	-50.5
25 Hz	0.0	-44.7
31.5 Hz	0.0	-39.4

保存

定义 权出厂值



:

分析
分析列

小时
小时全体




||

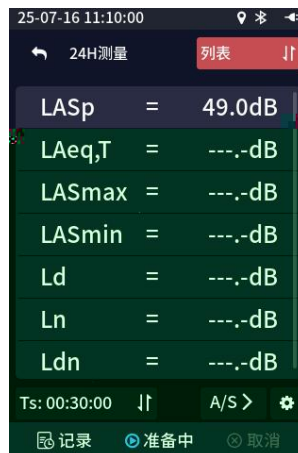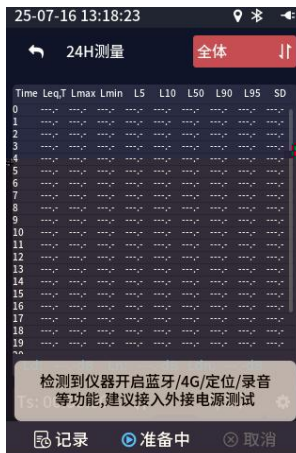

小时 列




小时 图形

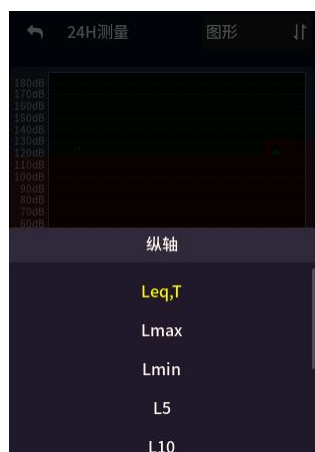


小时



声暴
声暴 列

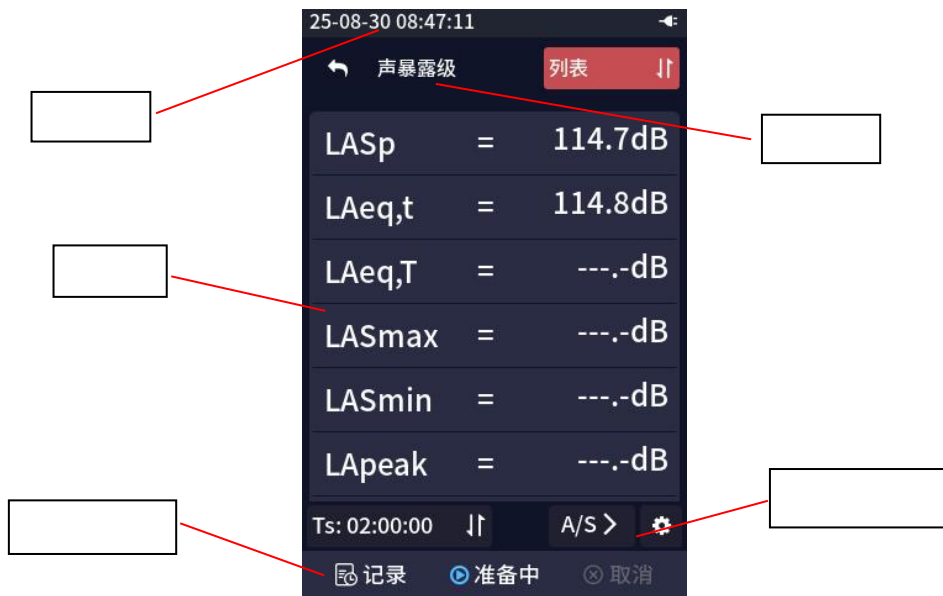

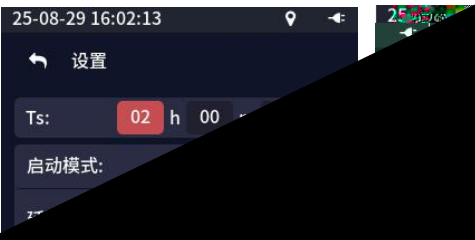

18+x

25




声功 区普查



交 噪声

声功 区 小时



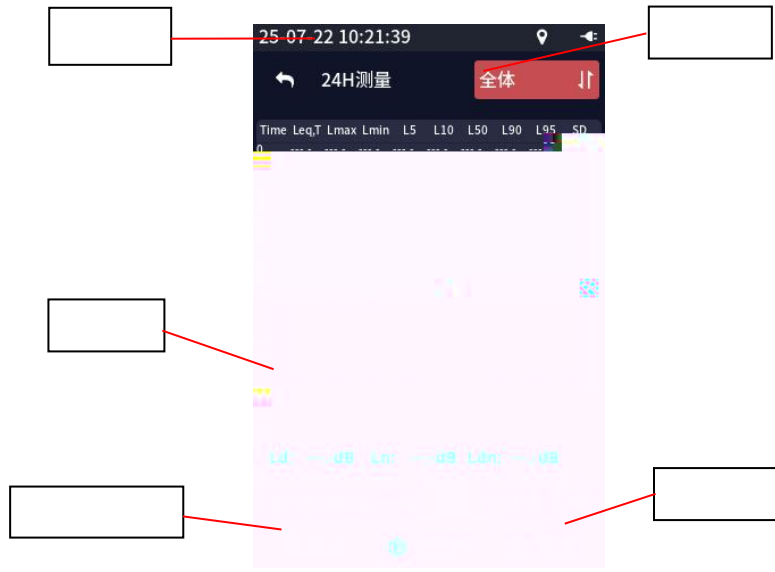





：

会 噪声排放




室内

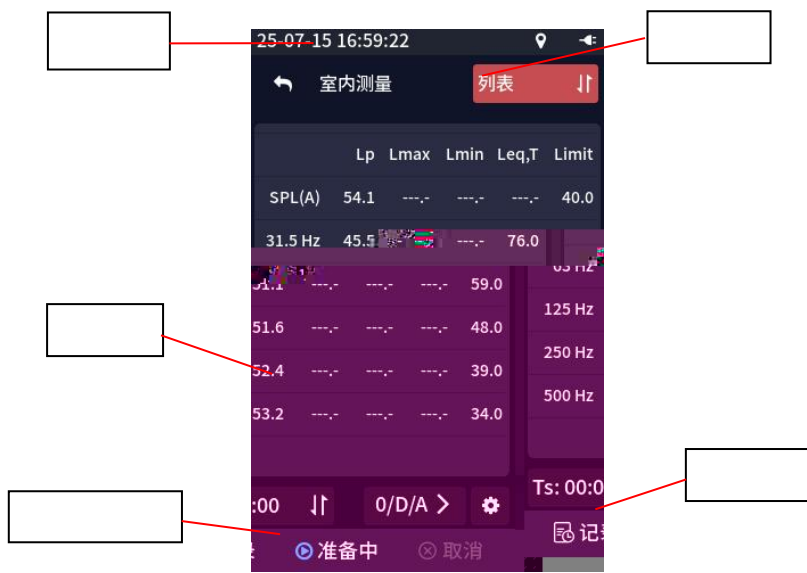

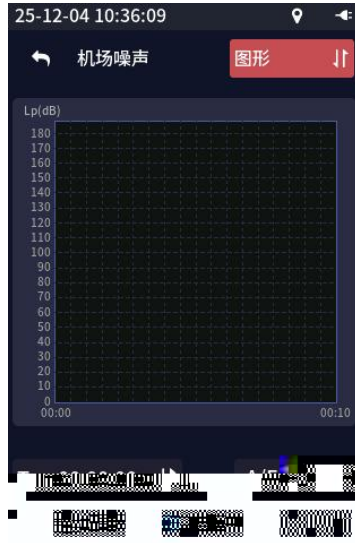




住宅内

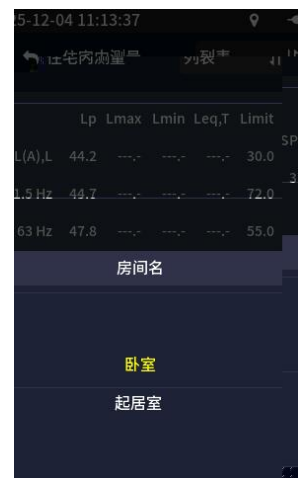

数据


本机数据

历史查

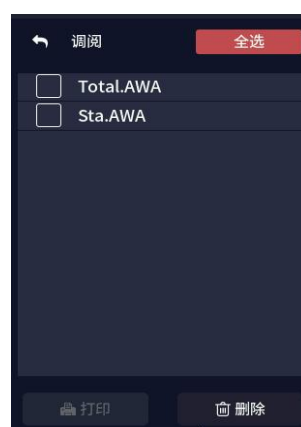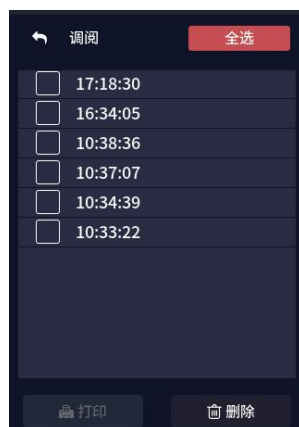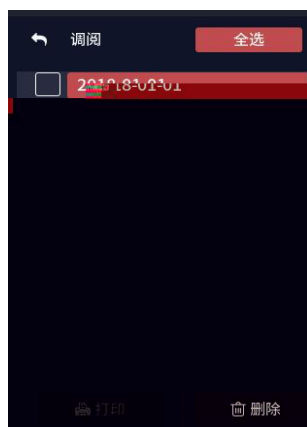

数据删

分历史 情

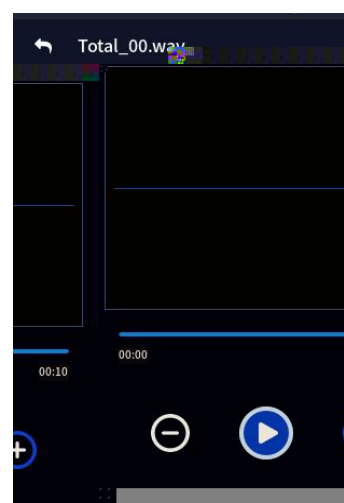

数字 录 情

录 文件





数据打印

接打印机

:


打印 接方式

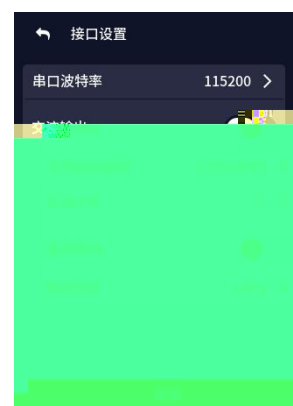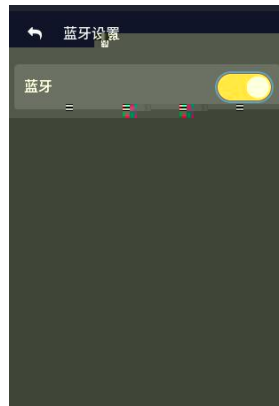

1

2

分 打印

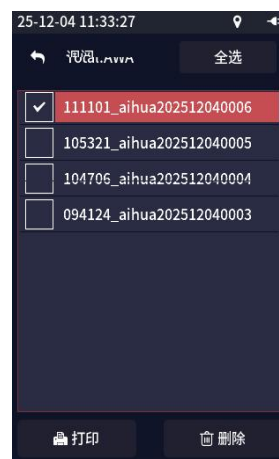

数据导出

仪器校准

校准





校

校准



校准 录

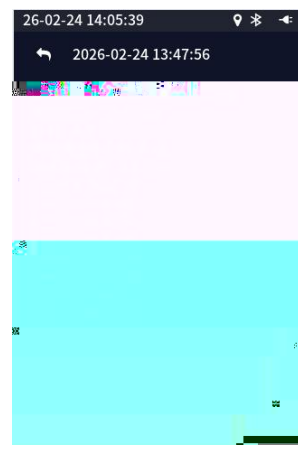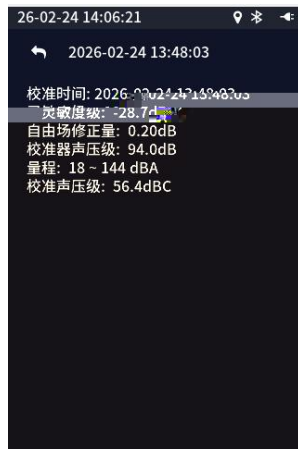

日志

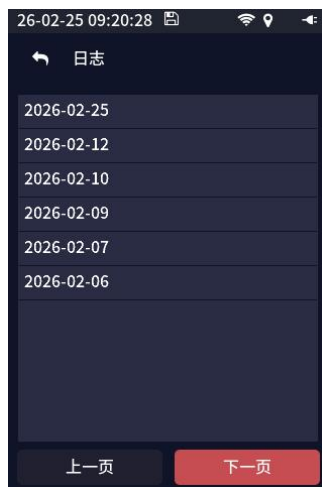


图 日志 录



图 天日志 录

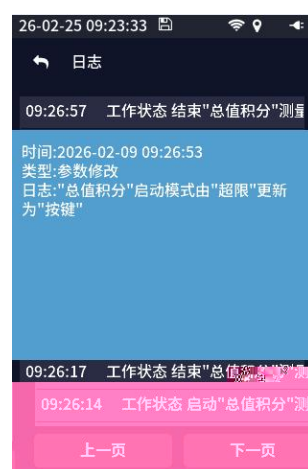


图 录 情

仪器


介



录



:

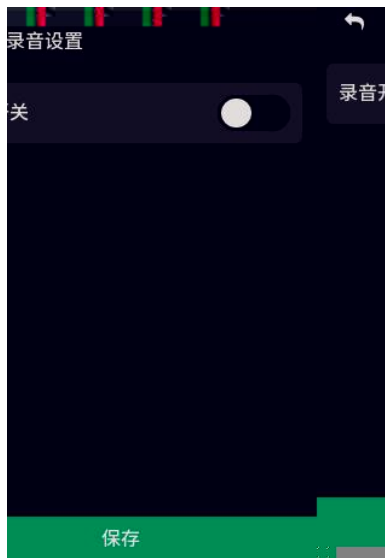


显



接口



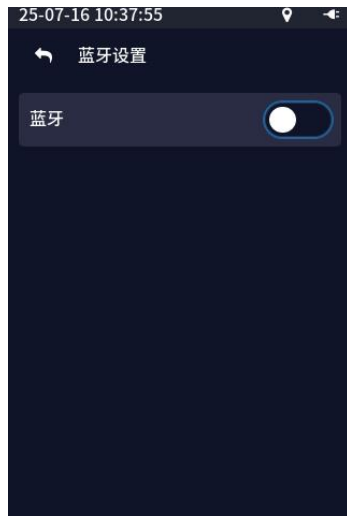

报



打印

仪


定时关机



存储


> '6

1:

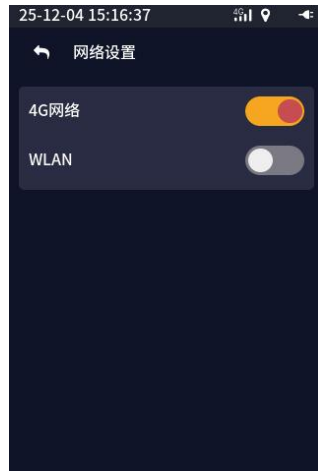

□

:

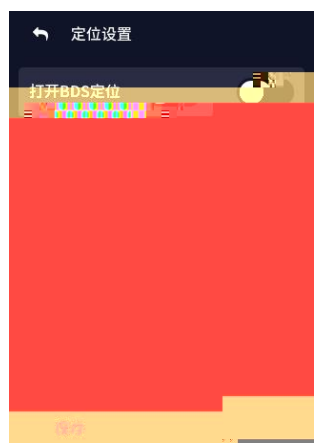


定位



:

昼夜


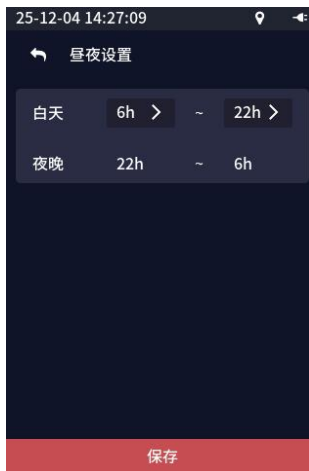



传声器

关于仪器

:



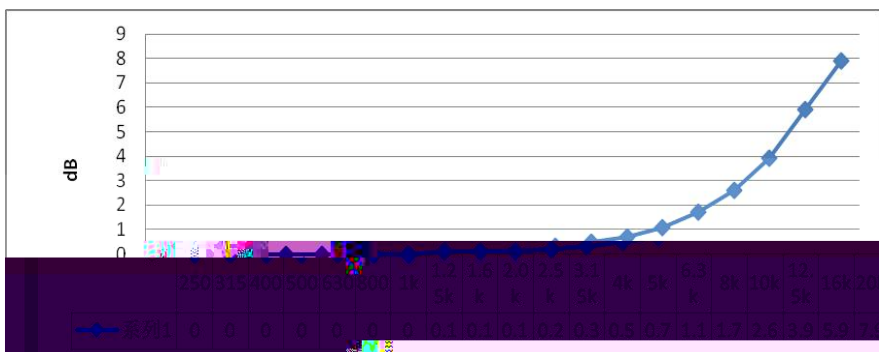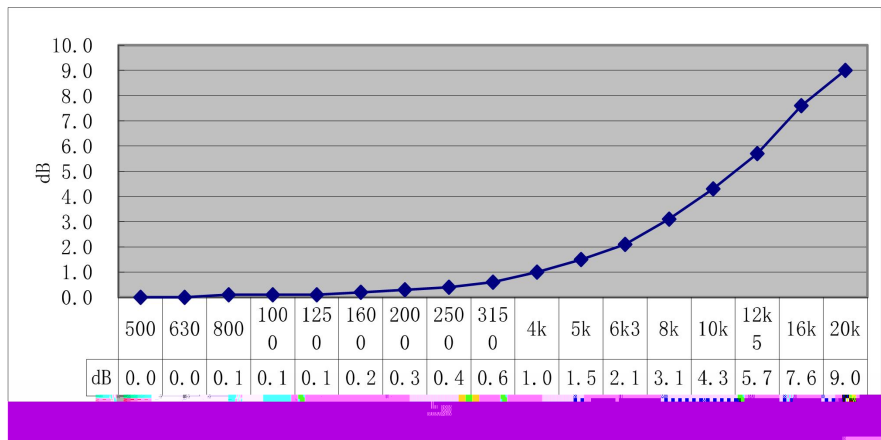

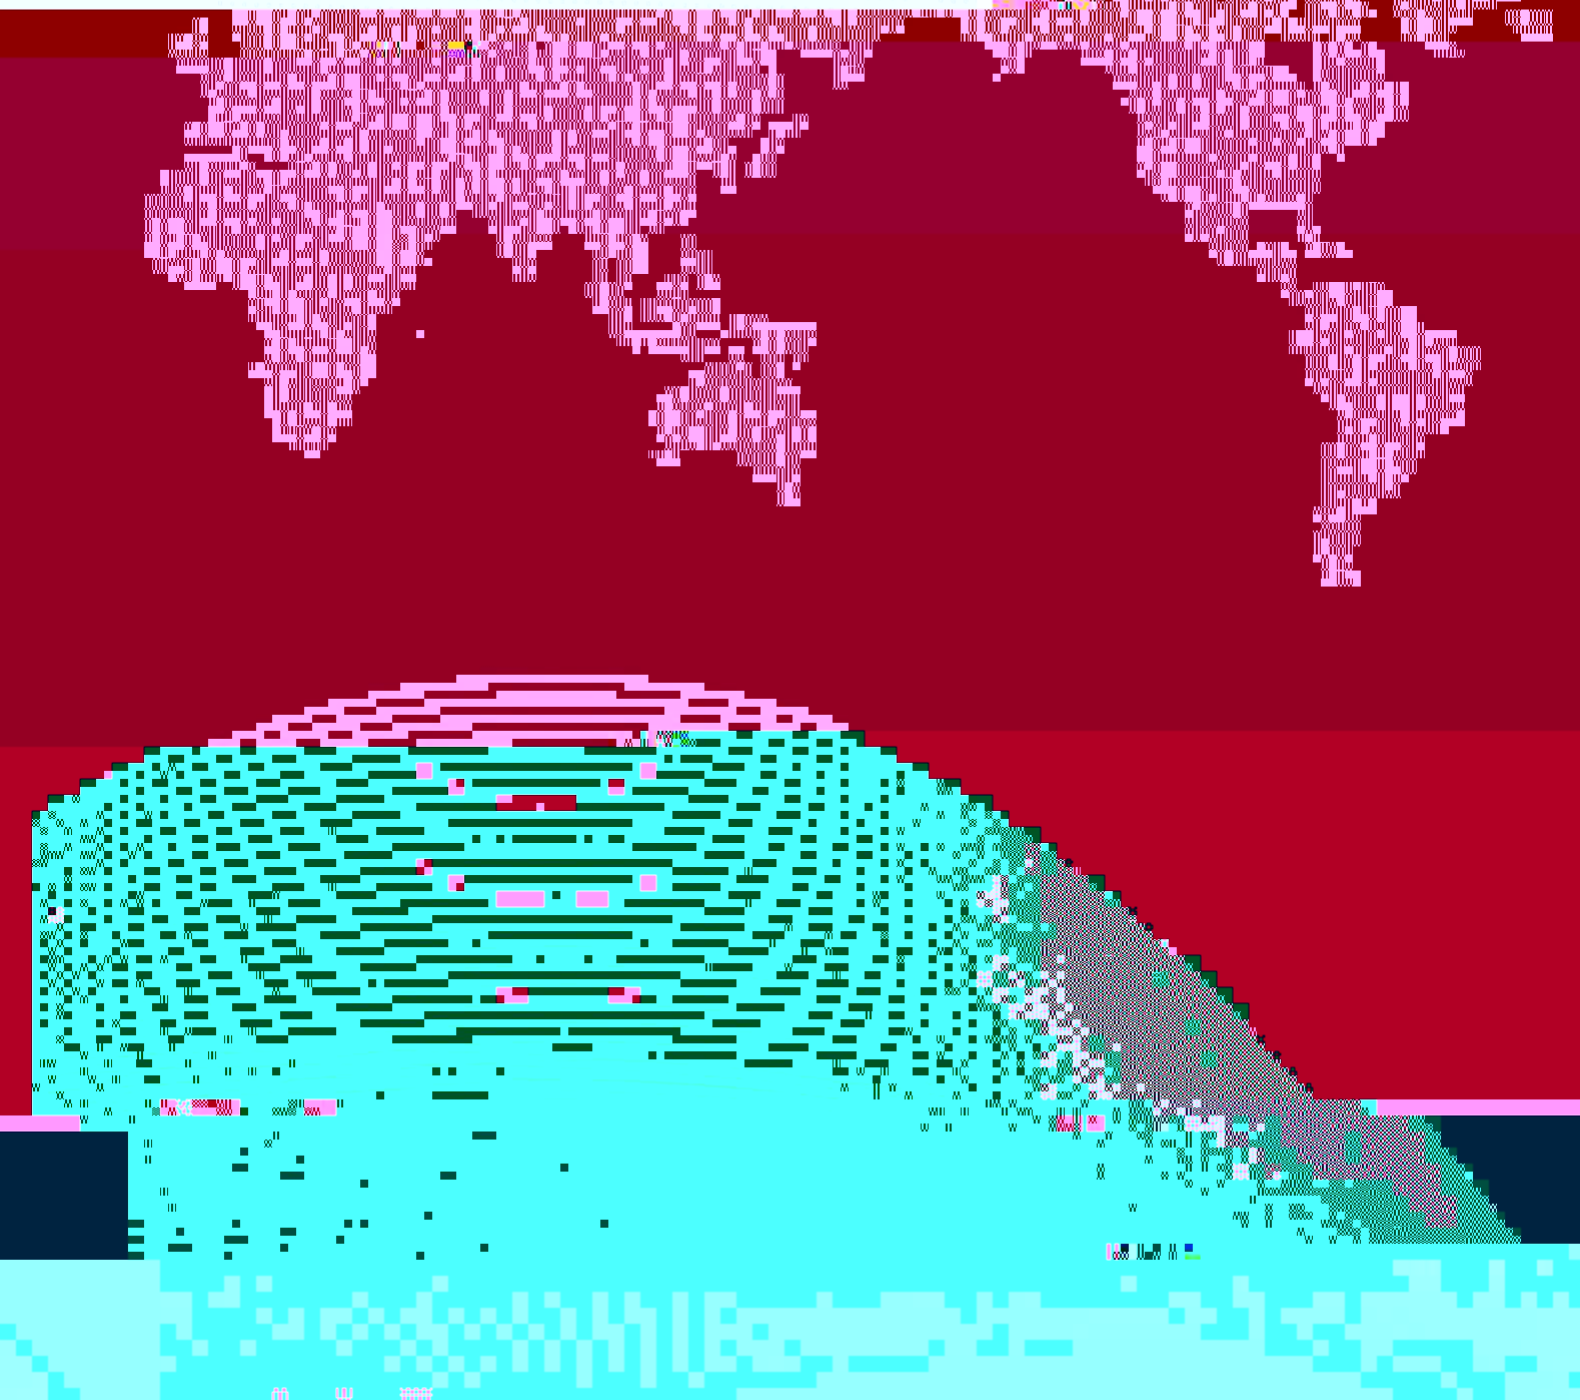

杭州爱华仪器有限公司
 HANGZHOU AIIWA INSTRUMENTS CO., LTD.

地址: 浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路111号
 邮编: 311411
 电话: 0571-87339999 传真: 0571-87339999
 网址: www.aiiwa.com
 邮箱: aiiwa@hangzhou.aiiwa.com.cn

